


Webinar #1/2024

Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind

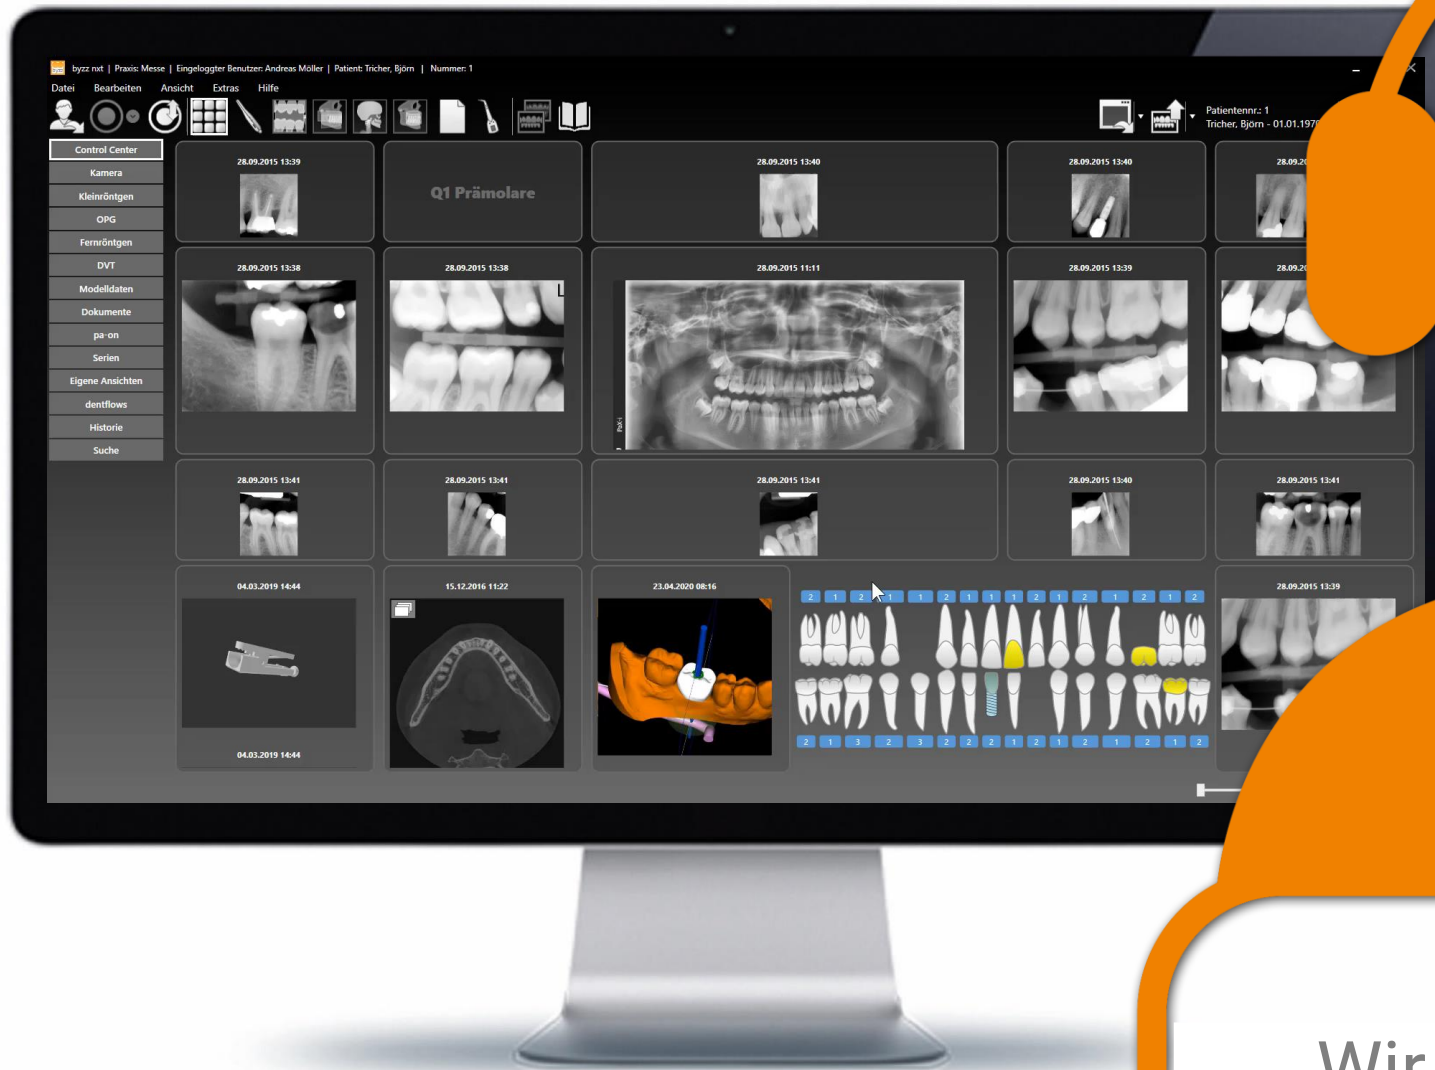

Wir starten um 18:30 Uhr

Willkommen beim od – Webinar #1/2024

Befunderhebung in der Paro:

Digital, praktisch, reproduzierbar

Ihre Moderatoren heute Abend

Dr. Valentino Luzzi




Dr. Frank Emde




Andreas Möller



1. Bitte klicken Sie für Ihre Frage hier.

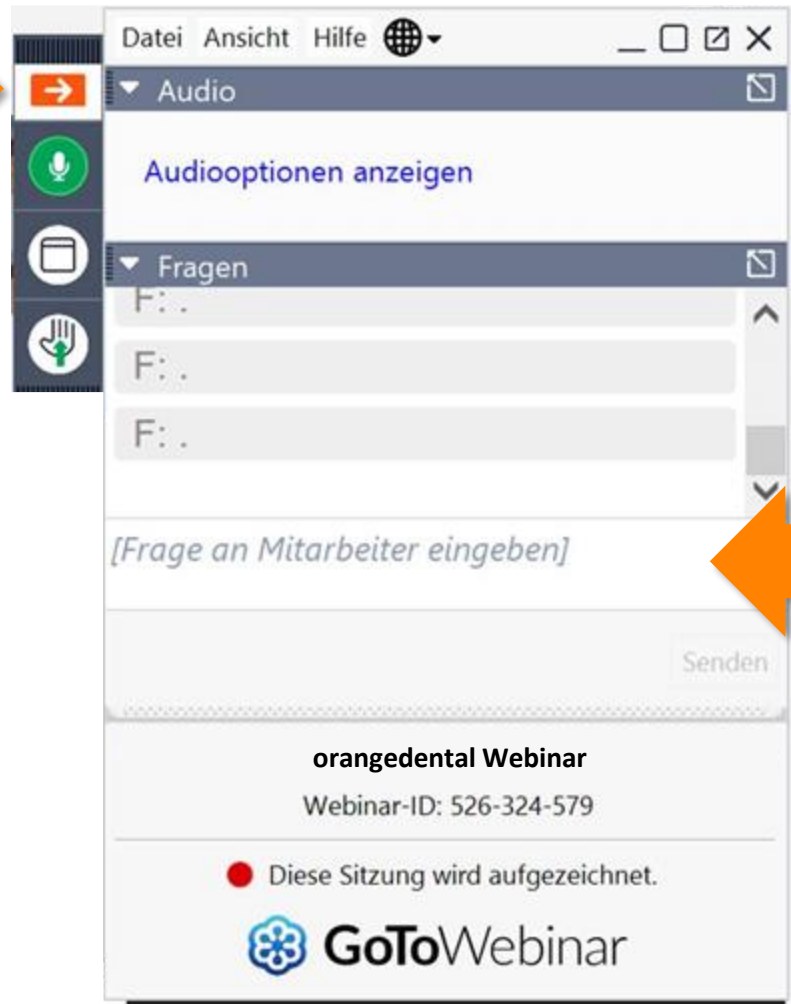

2. Stellen Sie uns Ihre Fragen im Fragen-Fenster

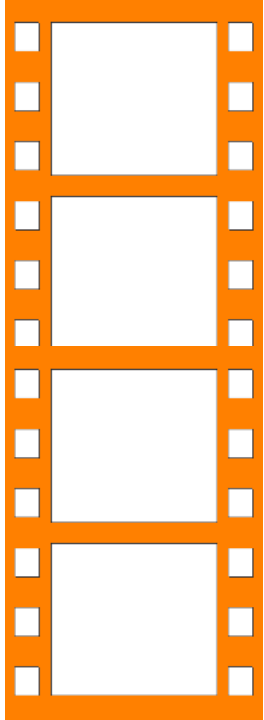

Sie erhalten das komplette, heutige Webinar als Video-Aufzeichnung zum späteren Anschauen.

Natürlich können Sie dieses Video auf für Ihre internen Praxis-Schulungen benutzen.





Ihre Meinungen und Wünsche sind uns sehr wichtig.

Bitte nehmen Sie an der Umfrage nach dem Webinar teil.



>> Und nun geht es los ...

Agenda

- >> Stellenwert der Befunderhebung in der Praxis
- >> Komponenten und Messverfahren
- >> byzz® nxt und Konfigurationen der pa-on
- >> Praxismanagement Software und byzz® nxt
- >> Praxismanagement Software und byzz nxt in der Praxis
- >> Vorbereitung und Messablauf
- >> Übertragung byzz® nxt/ Praxismanagement Software
- >> Röntgengebundene Messmethoden / Staging & Grading
- >> Abrechnung
- >> Zusammenfassung



Befunderhebung in der Paro: Digital, praktisch, reproduzierbar

Meine Praxis:



Drachenstarke Zähne !



>> Umfrage 1

1 von 3. Wie erfassen Sie zur Zeit die Taschentiefe und Attachmentverlust in Ihrer Praxis?

Multiple-Choice mit mehreren Antworten

71.43%

Starre Parodontalsonde (Stahlsonde)

14.29%

Mechanisch-druckkalibrierte Parodontalsonde

3.57%


Florida-Probe

21.43%

pa-on Sonde

>> Live ...


Stellenwert der Befunderhebung in der Praxis

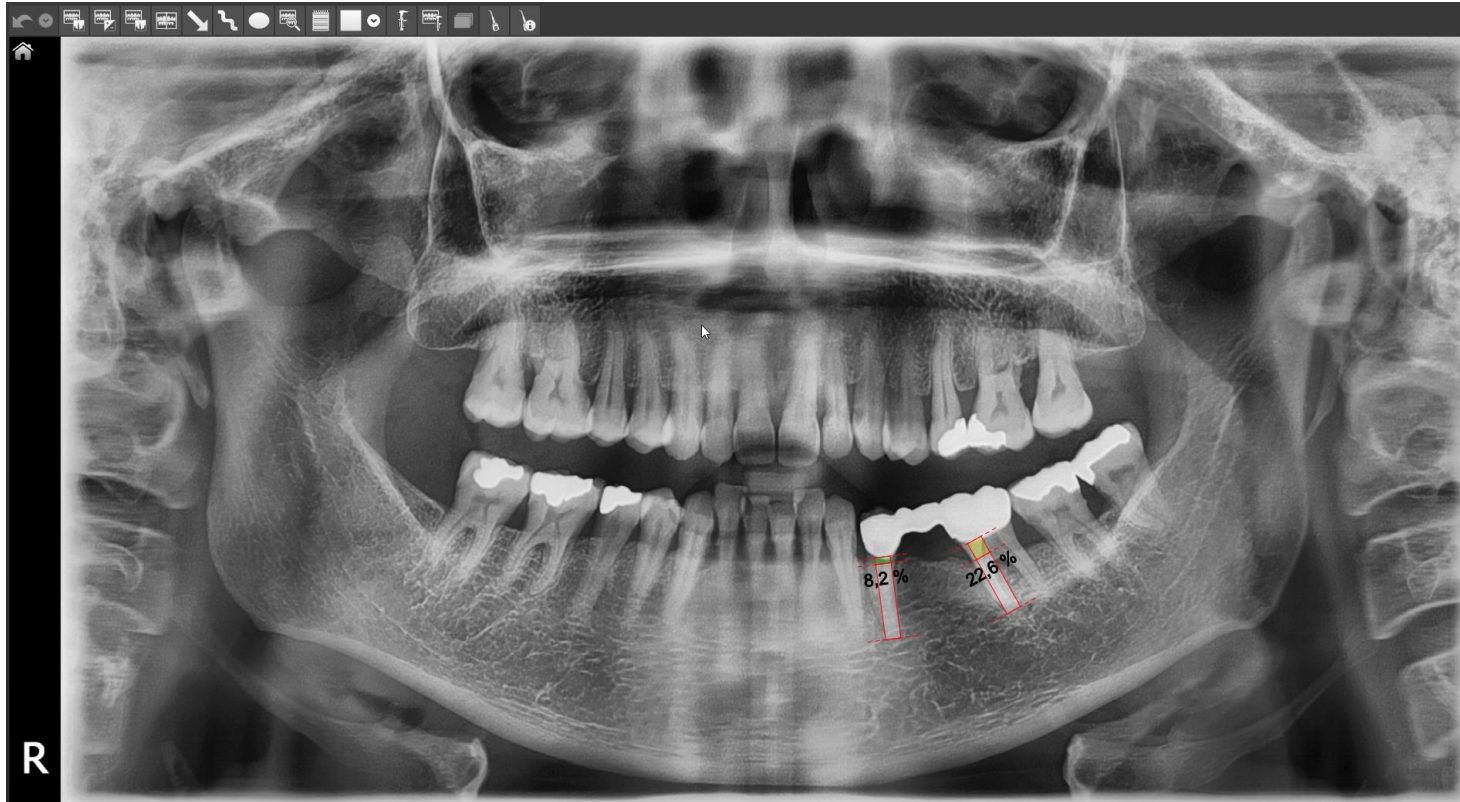


Komponenten und Messverfahren



**pa-on Sonde und
Dockingstation**
(Anschluss per USB an den PC
oder Laptop)



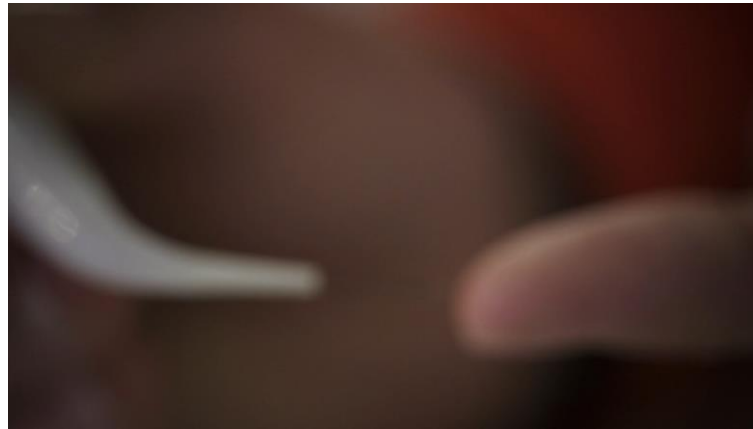


Messspitze (Druck konstant 20g)

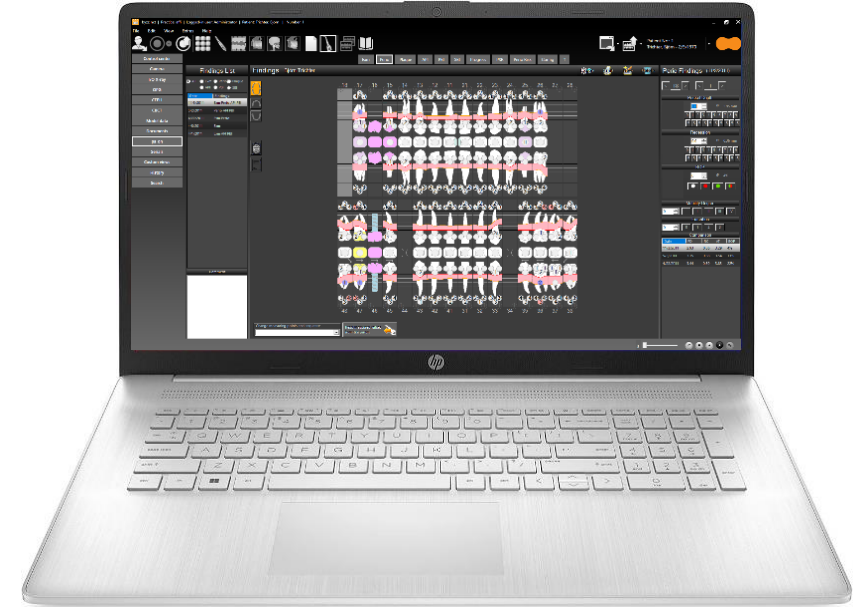



**Computer mit installierter
byzz® Paro Software**

Komponenten und Messverfahren

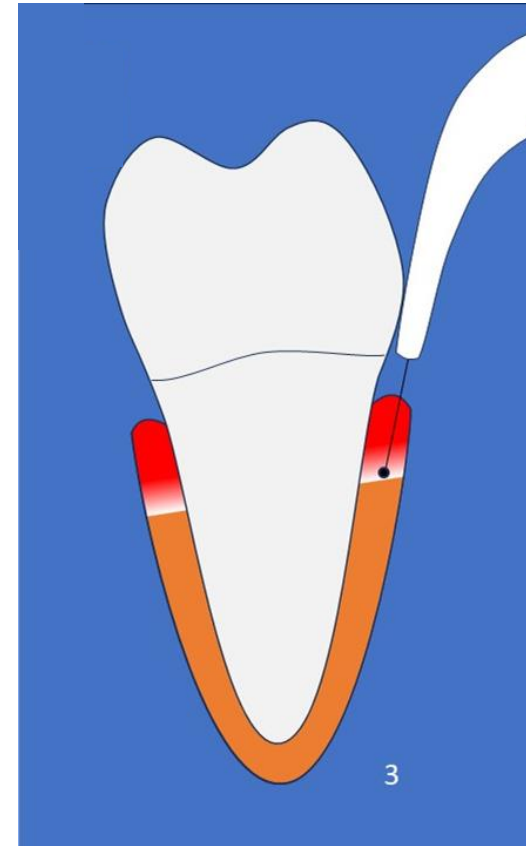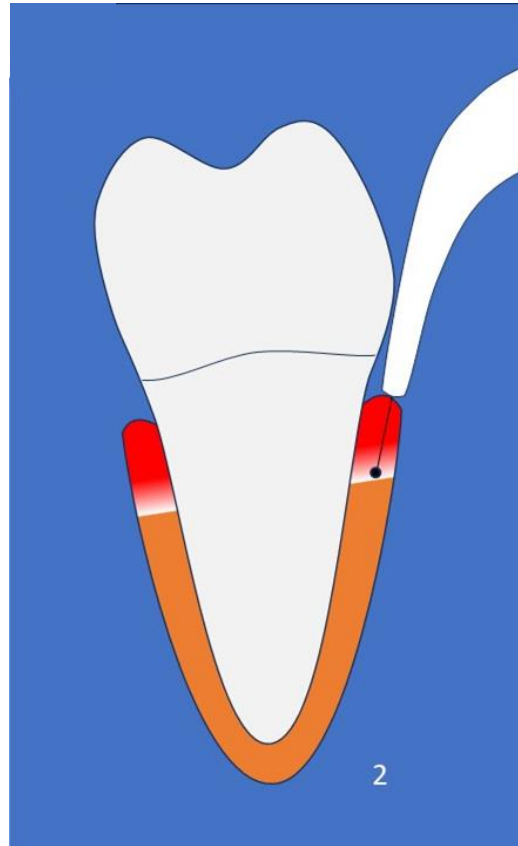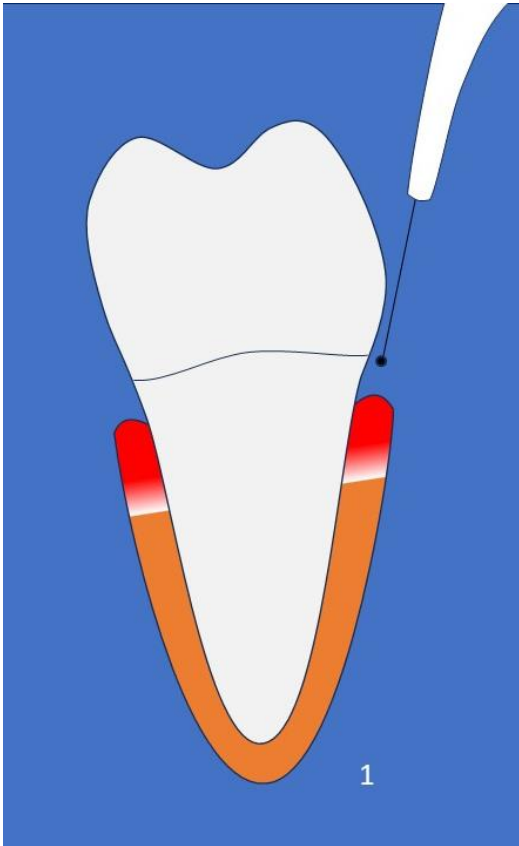

Befunderhebung in der Paro: Digital, praktisch, reproduzierbar

byzz® nxt und Konfigurationen der pa-on

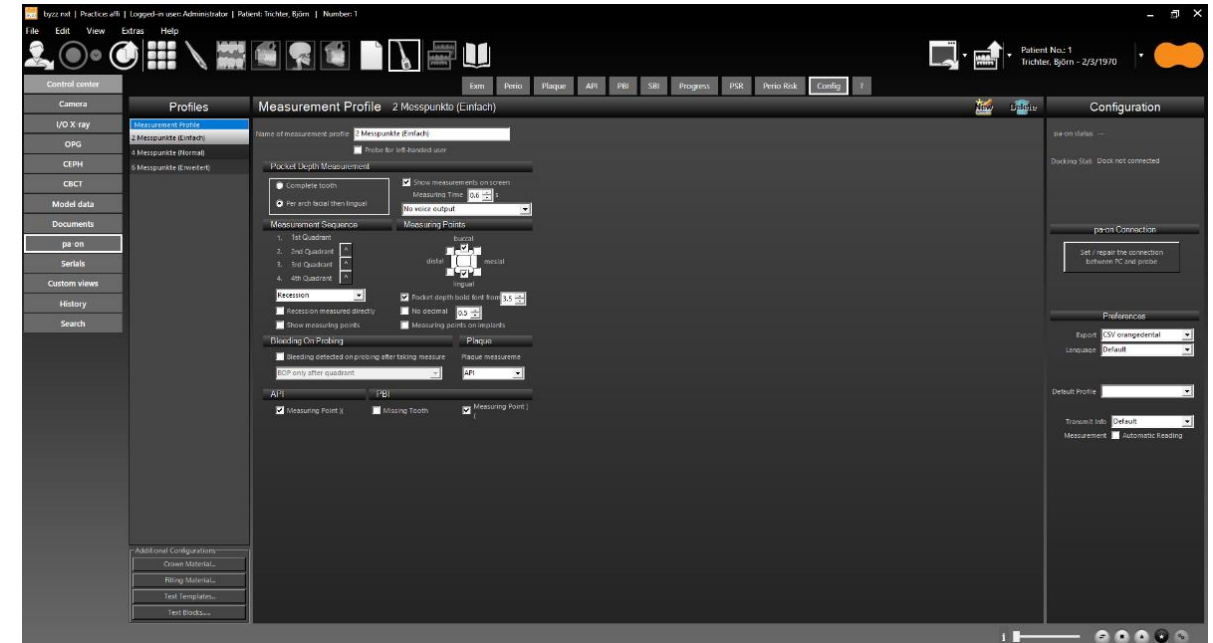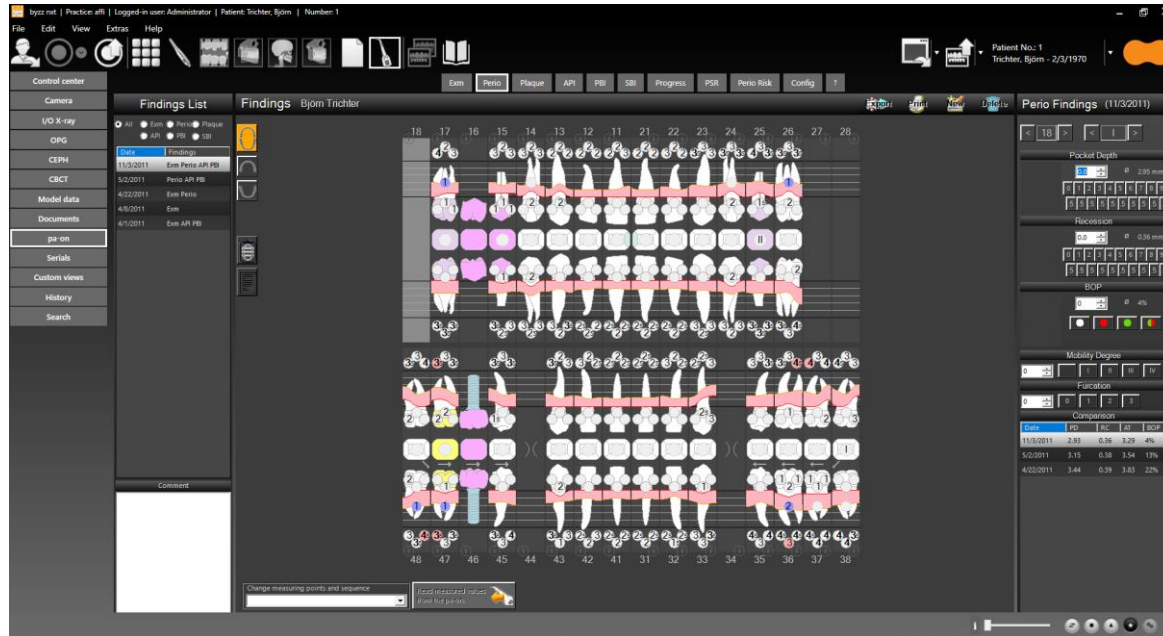

Praxismanagement Software und byzz® nxt

Auswahl Patient Leistungserfassung Akt. Befund HKP! KVA Labor KB! Formular View PAR Kartei Behandlungsplanung FA P I R M C O

Behandler: Greifenberg Parodontalstatus Blatt 2

	f		k	b	k		k	k							f
Reassess															
AIT		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CPT															

	f							k	k		k	b	k		f
CPT															
AIT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Reassess															

Planung Abrechnung

4PA 1 Bemerkung
ATG 1
MHU 1
AITa 16
AITb 10
BEVa 1
UPT 4

☐ Gutachterlich befürwortet
☐ § 27 SGB V

465 09.07.2021 AIT
468 27.01.2022 BEVa
467 09.06.2022 CPT

PAR-Info UPT-Rechner 2

Behandler 1 Greifenberg


Genehmigung: 10.07.2021
Behandlungsbeginn: 09.07.2021
Abschluss AIT: 28.07.2021
Behandlungsende: . . .

Drucken Neu Löschen Rückgängig Übernehmen


>> Umfrage 2

2 von 3. Welche Probleme sehen Sie bei der Durchführung der täglichen PA-Messungen?

Multiple-Choice mit mehreren Antworten

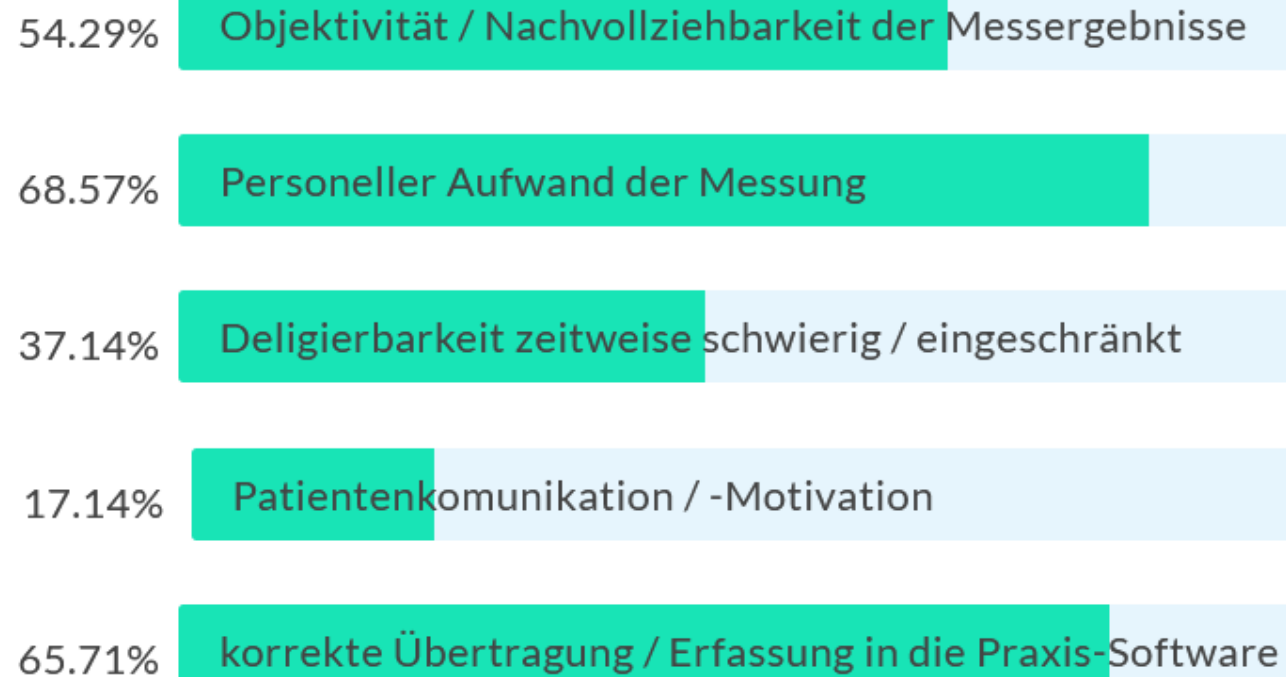


Praxismanagement Software und byzz® nxt in der Praxis

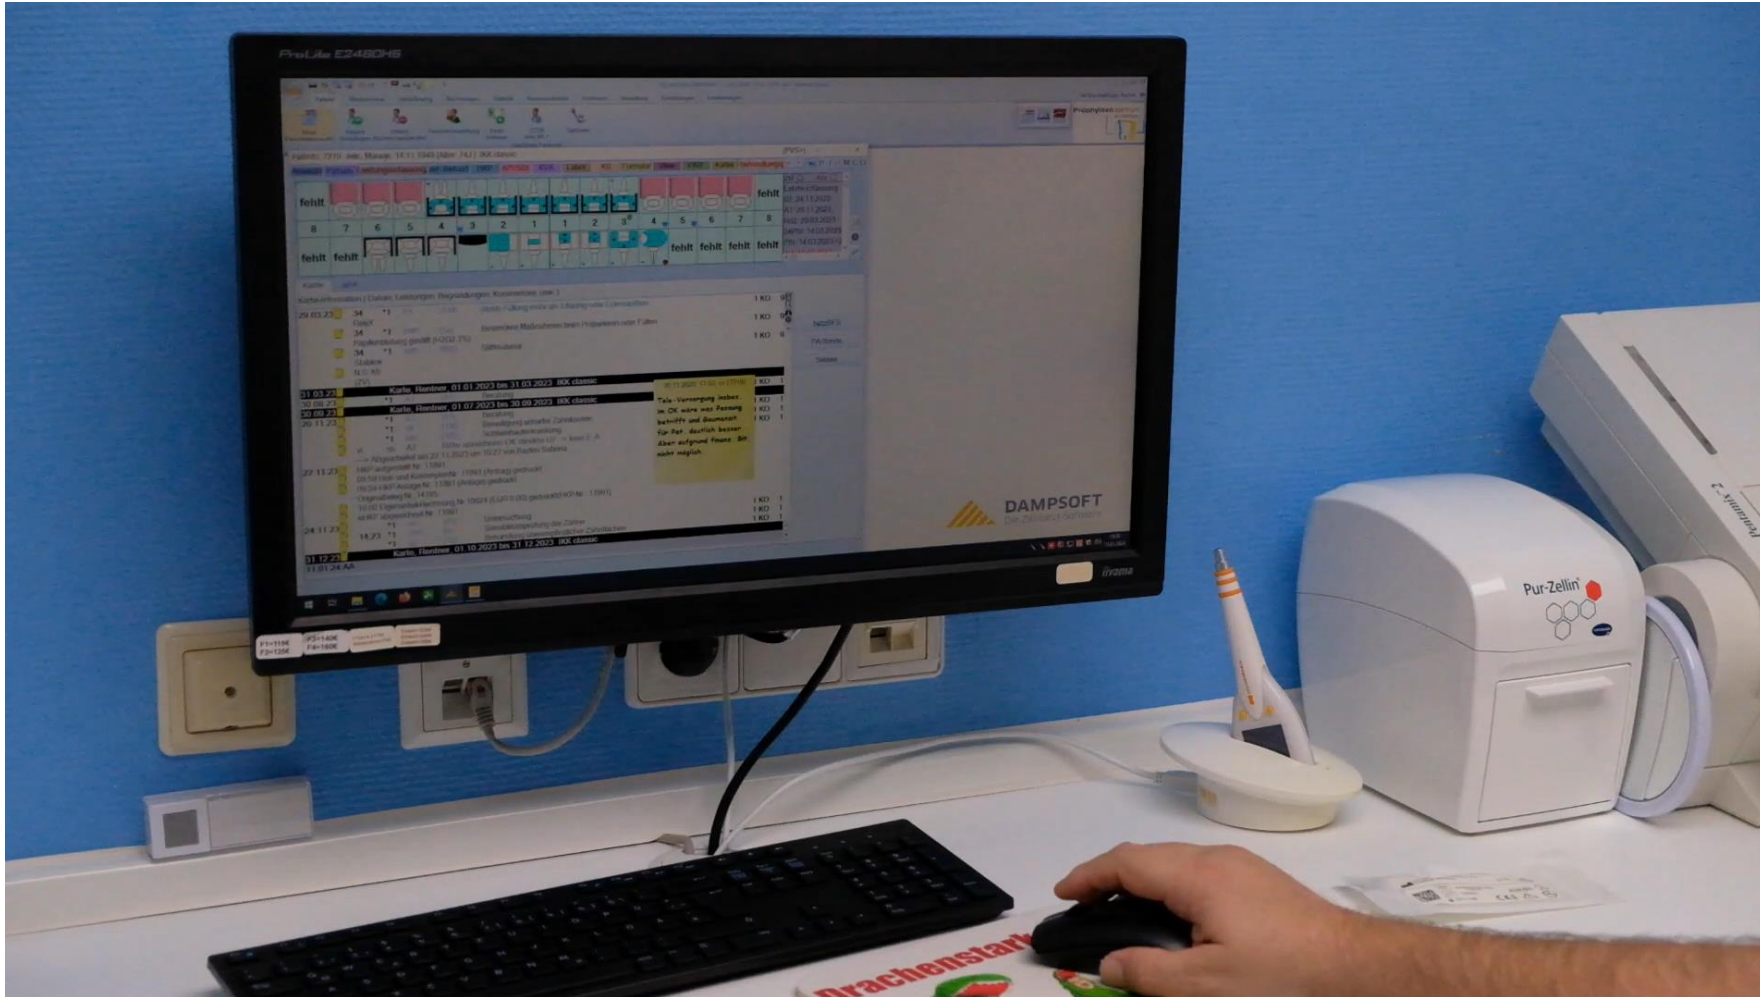

Vorbereitung und Messablauf am Patienten



Vorbereitung und Messablauf am Patienten

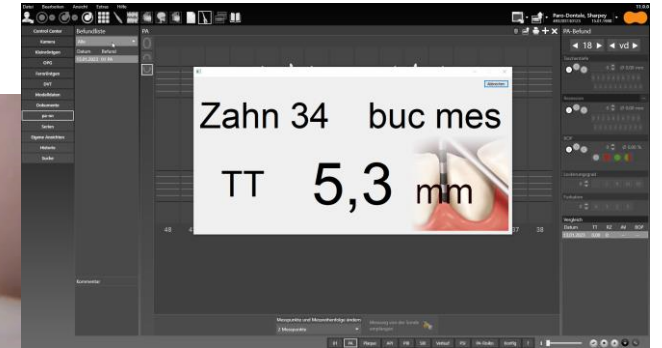

Übertragung byzz® nxt/ Praxismanagement Software



Röntgengebundene Messmethoden / Staging & Grading




Abrechnung pa-on

- >> GOZ 4000: Erstellen und Dokumentieren eines Parodontalstatus
Faktor 2.3: 20,70 Euro Faktor 3.5: 31,50 Euro
- >> GOZ 4005: Erhebung eines Gingivalindex (PSI)
Faktor 2.3: 10,35 Euro Faktor 3.5: 15,75 Euro
- >> Kassenpatienten: Im Rahmen der PA-Behandlung oder der UPT nicht
gesondert berechnungsfähig.
Messspitzen werden nicht extra berechnet.

>> Umfrage 3

3 von 3. Wann werden in Ihrer Praxis Taschentiefe / Atachmendverlust / BOP erfasst?

Multiple-Choice mit einer Antwort

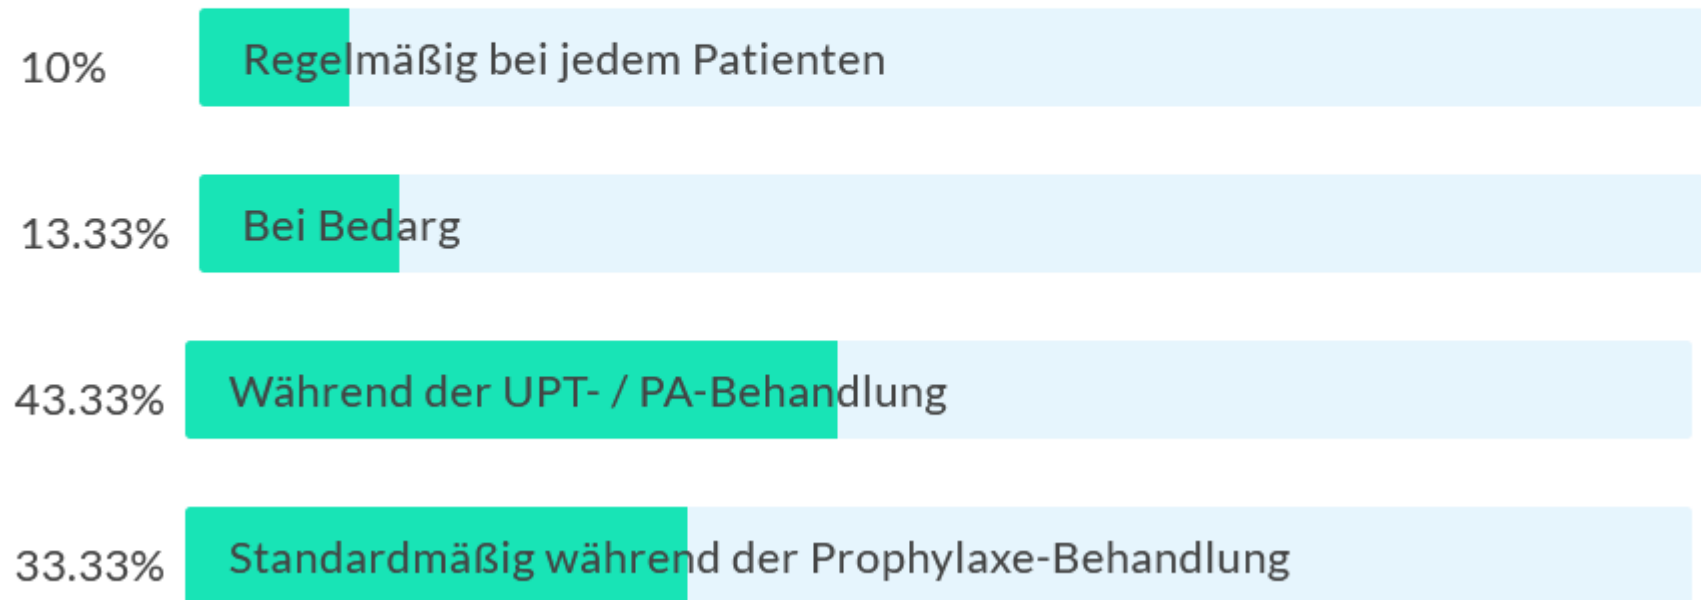

Zusammenfassung

- >> Standardisierte und reproduzierbare Messungen
- >> Individuelle Konfiguration
- >> Einbindung Praxismanagement-Software und byzz® Nxt
- >> Clevere Methode – keine Tippfehler bei der Übertragung
- >> Nur noch eine Assistenz notwendig
- >> Geringere Schmerzempfindung durch flexible Sonde
- >> Patientenmotivation durch grafische Darstellung und Sprachausgabe
- >> Objektive Messung, die von Patienten nachvollziehbar ist
- >> Schnelle Einarbeitung





Jan Klierer: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 151. 432 079 82
Mail: ijkl@orangedental.de

PLZ: 20-33, 38



Martin Loeffen: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 151. 515 86 23 3
Mail: mlo@orangedental.de

PLZ: 41, 45-49



Uwe Baltes: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 170. 189 40 02
Mail: uba@orangedental.de

PLZ: 34-37, 40, 42, 44, 50-59





Andreas Möller: Verkaufsleitung (BW/CH)
Leiter Softwareentwicklung (BC)

Mobil: +49 (0) 173. 966 84 36
Mail: am@orangedental.de

PLZ: 70-72, 75-79, 88 + Schweiz

Legende:

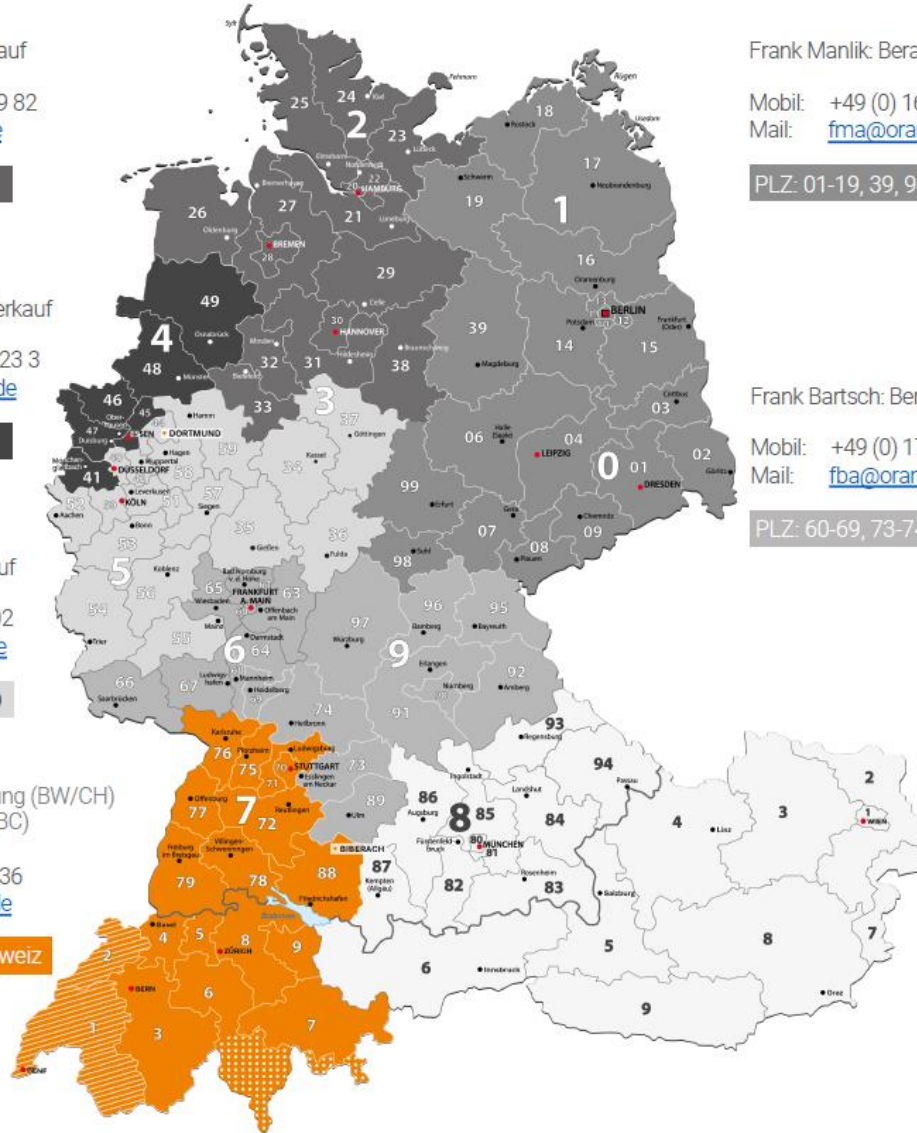

Frank Manlik: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 163. 251 631 0
Mail: fma@orangedental.de

PLZ: 01-19, 39, 98, 99



Frank Bartsch: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 173. 967 55 11
Mail: fba@orangedental.de

PLZ: 60-69, 73-74, 89-92, 95-97



Stefano Soprano: Beratung / Verkauf

Mobil: +43 (0) 676. 510 60 73 (AT)
+49 (0) 160. 944 58 045 (D)
Mail: sso@orangedental.de

PLZ: 80-87, 93-94 + Österreich

Wir freuen uns über Ihre Meinung und Kritik.

Ihr Feedback können Sie selbstverständlich vollkommen anonym
abgeben

Wohltuende Kritik ist konstruktiver als jedes Lob.

Webinar

orangedental
premium innovations

DDI inside

